diasend® Clinic

מדריך להתחלה מהירה

glooko

תוכן העניינים

מצא את המכשיר שלך 3-4

כיצד להתחיל בשימוש ב-diasend® Clinic 5

חבר את diasend® Transmitter לשקע החשמל שלך 5

ה-diasend® Transmitter מוכן לשימוש כאשר: 5

חבר את מכשיר המטופל ל-diasend® Transmitter 6

העבר נתונים 6

היכנס לחשבון diasend® Clinic שלך 6

הצגת הנתונים 7

יצירת פרופיל מטופל ושמירת מכשירי המטופל 7

הצגת הנתונים ממכשירי המטופל 8

שיתוף הנתונים 9

הצע למטופלים להעלות מהבית 9

יצירת דוחות והדפסה בפורמט PDF 9

הסברים על מחווני diasend® Transmitter: 10

התנהגות המשדר כאשר הכל פועל כשורה: 10

רשימת מכשירים תואמים 11

מצא את המכשיר שברשותך

מד סוכר

CGM

משאבת אינסולין

עט האינסולין

Abbott

FreeStyle 11
FreeStyle Flash 11
FreeStyle Freedom 11
FreeStyle Freedom Lite 11
FreeStyle InsuLinx 11
FreeStyle Lite 11
Freestyle Mini 11
FreeStyle Optium 11
FreeStyle Optium H 11
FreeStyle Optium Neo 11
FreeStyle Papillon 11
FreeStyle Papillon InsuLinx 11
FreeStyle Papillon Lite 11
FreeStyle Papillon Mini 11
FreeStyle Papillon Vision 11
FreeStyle Precision 11
FreeStyle Precision H 11
FreeStyle Xido 11
Optium Mini 11
Optium Xceed 11
Optium Xido 11
Precision Xceed 11
Precision Xtra 11

FreeStyle Libre 11
FreeStyle Navigator 19
FreeStyle Navigator II 11

Acon Laboratories

On Call® Advanced 12
On Call® Plus 12
On Call® Resolve 12
On Call® Vivid 12

AgaMatrix

WaveSense Jazz™ 12

Animas

IR1200 20
IR1250 20
2020 20
OneTouch Ping 20
OneTouch Vibe Plus 20
Vibe 20

Apex Bio

GlucoSure Extra 12
GlucoSure Max 12

Arkray

GlucoCard 01 12
GlucoCard Expression 12
GlucoCard Shine 12
GlucoCard Vital 12
GlucoCard X-meter 12
GlucoCard X-mini plus 12
Relion Confirm 12
Relion Prime 12

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 12
Contour 12
Contour link 12
Contour next 12
Contour next link 12
Contour next link 2.4 12
Contour next one 12
Contour next USB 12
Contour plus one 12
Contour TS 12
Contour XT 12
Contour USB 12

Beurer

GL50 evo 13

B. Braun

Omnitest 5 13

Cambridge Sensors

Microdot+ 13

Dexcom

G4 Platinum 13
G5 receiver 13
Touchscreen reciever G5/G6 13
SEVEN PLUS 13

Diatesse

XPER 13

Everymed

EveryX3 13

ForaCare

FORA Diamond MINI 19
FORA Diamond Prima 13

GE

GE100 13

GlucoRx

HCT & Ketone 14
Nexus 14
Nexus Mini 14
Nexus Mini Ultra 14
Nexus Voice 14
Q 14

iCare

PalmDoc I 14
PalmDoc II 14

Infopia

Element 14
Finetest Lite 14
GlucoLab 14
GluNEO 14

Insulet

OmniPod 20
OmniPod Dash 20

Inside Biometrics

KEYA Smart 14

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS 14
alphacheck professional 14
COOL/Bravo 14
CareSens BGMS/TEE2 14
CareSens N 14
CareSens N POP 14
CareSens N Voice 14

LifeScan

OneTouch Ping 15
OneTouch Select 15
OneTouch Select Plus 15
OneTouch Select Plus Flex 15
OneTouch Ultra 15
OneTouch Ultra2 15
OneTouch UltraEasy 15
OneTouch UltraMini 15
OneTouch UltraSmart 15
OneTouch Verio 15
OneTouch Verio (old) 15
OneTouch Verio Flex 15
OneTouch Verio IQ 15
OneTouch Verio Pro 15
OneTouch Verio Sync 15
OneTouch Vita 15

Medcore

Care 15
GlucoSure Extra 15
GlucoSure Max 15

Menarini

GLUCOCARD MX 15
GLUCOCARD SM 15
GLUCOFIX iD 15
GLUCOFIX miò 16
GLUCOFIX miò Plus 16
GLUCOFIX Premium 16
GLUCOFIX TECH 15
GlucoMen areo 15
GlucoMen areo 2K 15
GlucoMen G+ 16
GlucoMen Gm 15
GlucoMen LX 16
GlucoMen LX2 16
GlucoMen LX Plus 16
GlucoMen READY 16
GlucoMen Visio 16

Mendor

Discreet 16

Nipro

4SURE Smart 16
4SURE Smart Duo 16
TRUE METRIX 16
TRUE METRIX AIR 16
TRUEresult 16
TRUEyou 16
TRUEyou mini 16

Nova

Max Link 16
Max Plus 16

Pendiq

pendiq 22

Pic Solution

Pic Gluco Test 16

Prodigy

AutoCode 16

Roche

Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva 18
Accu-Chek Aviva Combo 18
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Expert 18
Accu-Chek Compact 18
Accu-Chek Compact Plus 18
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Instant S 17
Accu-Chek Mobile (IR) 18
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 18
Accu-Chek Performa 18
Accu-Chek Performa Connect 17

Accu-Chek Insight 21
Accu-Chek Spirit 21
Accu-Chek Spirit Combo 21

Sanofi

BGStar 17
MyStar Extra 17

Senseonics

Eversense CGM Transmitter 17

SOOIL

DANA Diabecare R 22

Smiths Medical

CoZmo 1700 20

Tandem

t:flex 20
t:slim 20
t:slim X2 20
t:slim G4 20

Terumo

Finetouch 17

ViCentra

Kaleido 20

VivaChek

Fad 17

Wellion

Calla Dialog 17
Calla Light 17
Calla Mini 17
Calla Premium 17
Galileo GLU/KET 17
Leonardo GLU/KET 17
Galileo GLU/CHOL 17
Leonardo GLU/CHOL 17
Linus 17

Ypsomed

mylife Pura 17
mylife Unio 17

mylife OmniPod 20

מדריך מהיר
diasend® Clinic

diasend® מעניק לספקי שירותי בריאות פתרון מקוון שאוסף ושומר באופן מרוכז את כל נתוני מטופלי הסוכרת שלהם, מבלי לדאוג להתקנת תוכנה כלשהי. ללא קשר לאופן העברת הנתונים על ידי המכשיר, בין אם על ידי כבל, Bluetooth, אינפרה-אדום או אפליקציית מובייל, כל המידע המועלה יוצג מידית באופן מקוון בחשבון diasend.com מאובטח. כל הנתונים ממכשירים מרובים ישולבו ויוצגו בדו"ח אחד.

כיצד להתחיל בשימוש ב-diasend® Clinic

1 חבר את diasend® Transmitter לשקע החשמל שלך

2 ה-diasend® Transmitter מוכן לשימוש כאשר:

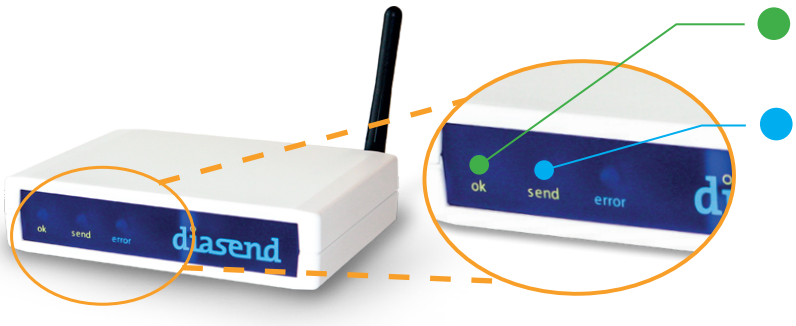

1. מחוון ok הירוק הפסיק להבהב.
   הבהוב בקצב איטי משמעו המשדר מאותחל.
   הבהוב בקצב מהיר משמעו המשדר מתעדכן.
2. מחוון send כחול מהבהב בקצב איטי.

i הערה: אנא עיין בעמוד 10 להסבר מורחב על המחוונים ב-diasend® Transmitter.

i הערה: אם יש לך רכזת USB המחוברת ל-diasend® Transmitter, אנא שים לב שרכזת ה-USB חייבת להיות מופעלת על ידי ספק כוח עצמאי.

3 חבר את מכשיר המטופל ל-diasend® Transmitter

כל מכשיר מטופל מתחבר באחד משלושת האופנים שלהלן:

- כבל USB (יציאת USB או רכזת USB)
- Bluetooth (נדרש התקן Bluetooth ספציפי)
- אינפרה-אדום (מקלט IR מובנה או עבור מכשירים מסוימים כבל SmartPix).

i אנא עיין בעמוד 11 של מדריך זה להוראות ספציפיות על אופן ההעלאה של כל מכשירי המטופלים התואמים.

4 העבר נתונים

1. חבר את מכשיר המטופל – מחוון send הכחול יהבהב בקצב מהיר בעת העלאת הנתונים.
2. המתן עד אשר המחוון send הכחול יפסיק להבהב בקצב מהיר והמחוון ok הירוק יידלק.
3. לאחר שהמחוון ok הירוק נדלק, באפשרותך להיכנס לחשבון ולצפות בנתונים ב- www.diasend.com או להמשיך ולהעלות מכשירי מטופלים נוספים. לחץ על טען את העמוד מחדש אם כבר נכנסת לחשבון. שים לב שכיוון ש-diasend® מבוסס ענן, תוכל לעיין בנתונים שהועלו בכל עת.

5 היכנס לחשבון diasend® Clinic שלך

עבור ל-www.diasend.com כדי להיכנס ל-diasend® ולאחזר את הנתונים שהועלו.

6 הצגת הנתונים

מרפאה ← בלשונית המרפאה ניתן להציג את הנתונים מבלי ליצור פרופיל מטופל.

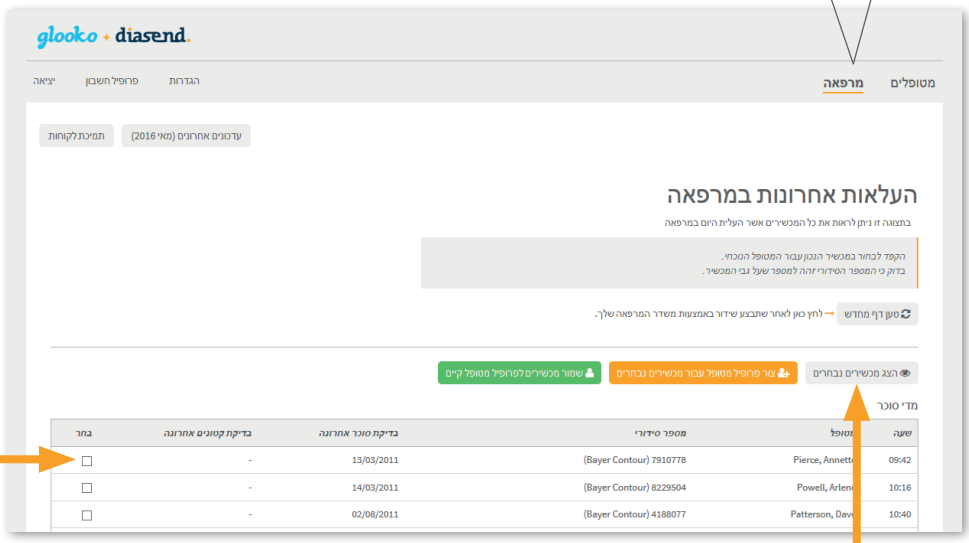

1 סמן את התיבה של ההעלאה שברצונך להציג

2 לחץ על הצג מכשירים נבחרים כדי להציג את ההעלאה.

i *שים לב שכל ההעלאות מוסרות מתצוגת המרפאה לאחר חצות של אותו היום, אך הנתונים אינם נמחקים.*

---

7 יצירת פרופיל מטופל ושמירת מכשירי המטופל

ישנן שתי דרכים ליצירת פרופיל מטופל. בלשונית המרפאה ובלשונית המטופל.

מרפאה ← כיצד ליצור פרופיל מטופל בלשונית המרפאה:

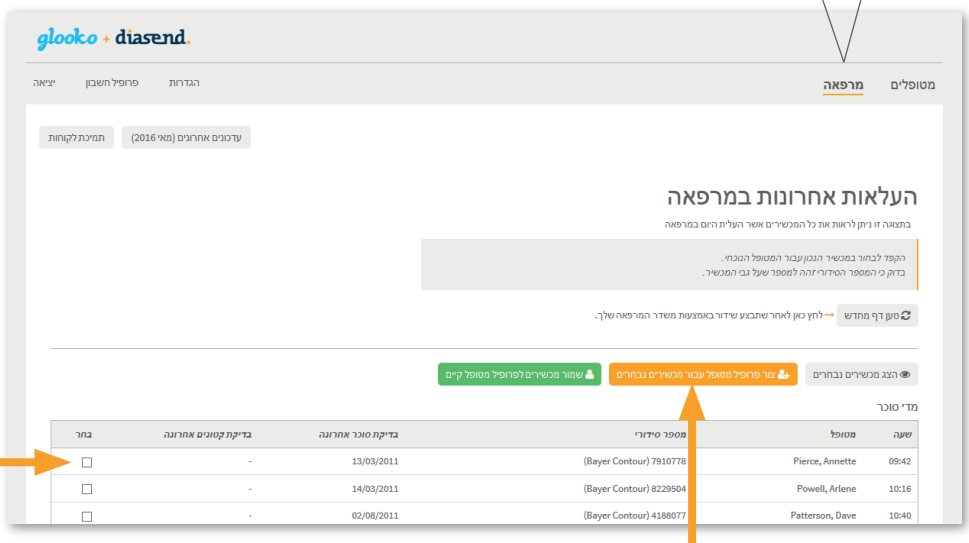

1 סמן את תיבת ההעלאה שעבורה ברצונך ליצור פרופיל מטופל.

2 לחץ כאן ליצירת פרופיל מטופל עבור המכשיר שנבחר.

i *אנו ממליצים על השיטה הזאת של רישום מכשירים עבור מטופל, על מנת להימנע מרישום ידני של מכשיר המטופל בלשונית המטופל.*

המשך מהעמוד הקודם.

מטופלים ← כיצד ליצור פרופיל מטופל בלשונית המטופל:

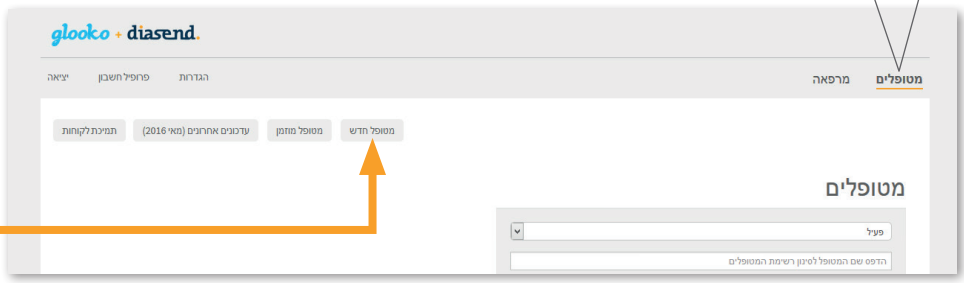

1 לחץ על מטופל חדש.

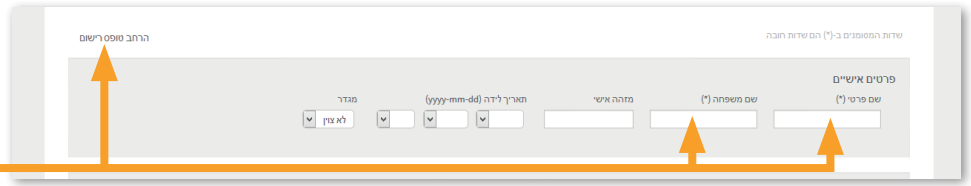

2 שדות החובה הם שם פרטי ושם משפחה. תוכל למצוא אפשרויות נוספות תחת הרחב טופס רישום.

3 כדי לאפשר למטופל לצפות בנתונים שלו מהבית, סמן את התיבה:
"ולהציג דוחות ®diasend מאפשר למטופל להיכנס למערכת"

- אם תנהג כך בתהליך הרישום יהיה עליך ליצור שם משתמש וסיסמה עבור המטופל.
- אם תסמן את התיבה לאחר יצירת חשבון המטופל, תבחין ש- ®diasend יצר שם משתמש עבורך. במקרה כזה, עליך רק ליצור סיסמה.



4 לאחר שתסיים, לחץ על:
"שמור פרטי מטופל".

8 הצגת הנתונים ממכשירי המטופל

סוכר | חיישן | אינסולין | השוואה | סיכום

הנתונים מוצגים בחמשת הלשוניות לעיל, שם תוכל למצוא את נתוני הסוכר, CGM והאינסולין. אנא עיין ב-®diasend Report reference guide באתר האינטרנט שלנו לקבלת פרטים נוספים לגבי הדוחות שלנו.

9 שיתוף הנתונים

מטופלים בעלי חשבון diasend® Personal משלהם יכולים להעלות את מכשירי המטופל בבית, והם יכולים לשתף את הנתונים המועלים על ידם עם שני מוסדות בריאות שונים לכל היותר. כדי לאפשר למטופלים לשתף את הנתונים עמכם, הם יצטרכו את המזהה הייחודי שלכם ב-diasend® הנקרא "מזהה מרפאה". תמצא אותו תחת "קישורי מטופלים" > "פרופיל חשבון".

10 הזמן מטופלים להעלות מהבית

כדי להקל על המרפאות והמטופלים לשתף נתונים הוספנו לחצן הזמנה באפליקציית האינטרנט. פירוש הדבר שמרפאות יכולות להציע למטופלים להעלות נתונים מביתם.

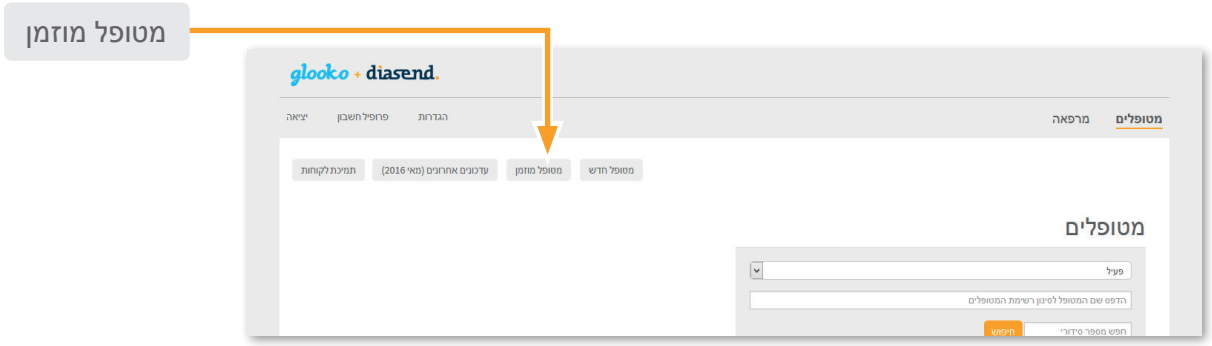

11 יצירת דוחות והדפסה בפורמט PDF

ישנן שתי דרכים להפיק דוח בפורמט PDF. באפשרותך ללחוץ על הצלמית "PDF-הדפס ל" כדי להפיק מיד דוח של התצוגה הנוכחית. או לחלופין תוכל ללחוץ על הלחצן 'אשף PDF' כדי להפיק דו"ח עם משתנים שנקבעו מראש. באפשרותך לכוונן את הכלי הזה תחת "הגדרות".

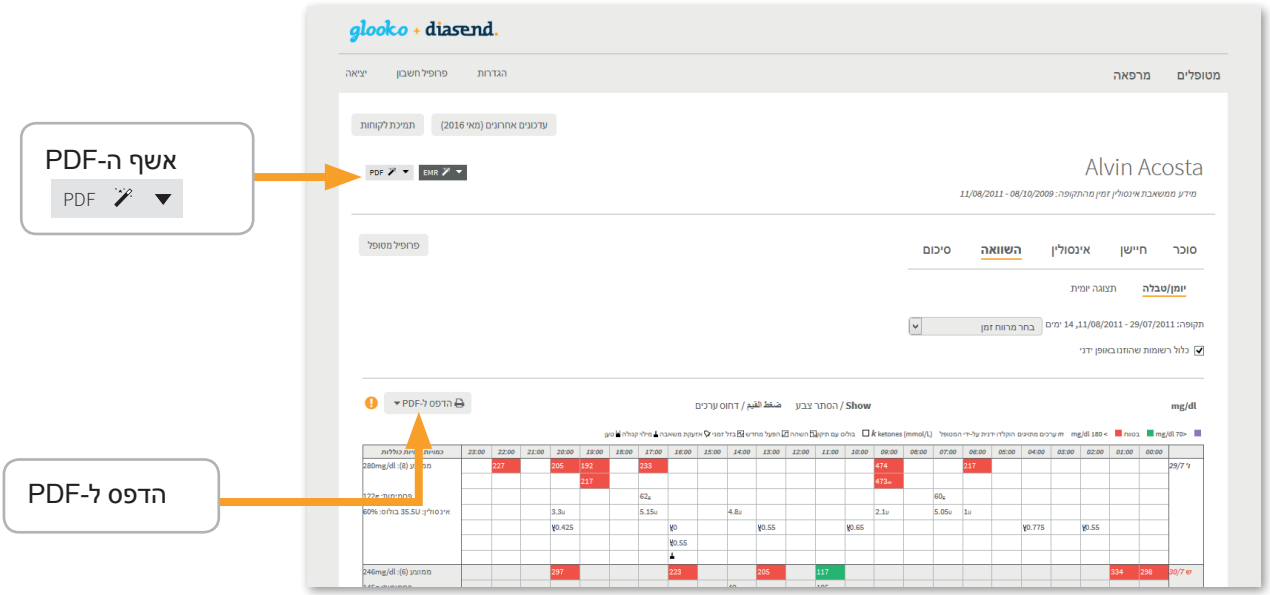

הסברים על מחווני diasend® Transmitter:

- הבהוב בקצב איטי
  מחוון ה-ok מהבהב בקצב איטי כאשר המשדר מתחבר לרשת ה-GSM.
- הבהוב בקצב מהיר
  המשדר מתעדכן. מחוון ה-ok מהבהב בקצב מהיר ובמשך פרק זמן ממושך. באפשרותך להתחיל להשתמש במשדר לאחר שמחוון ה-send מהבהב שוב בקצב איטי.
- אור קבוע
  במחוון מסמן העלאה שהסתיימה בהצלחה.

- הבהוב בקצב איטי
  המשדר מוכן לשימוש.
- הבהוב בקצב מהיר
  הנתונים מועלים.

- אור קבוע
  במחוון מסמן שההעלאה האחרונה לא הסתיימה בהצלחה. זה ככל הנראה כתוצאה מבעיות זמניות הקשורות לרשת ה-GSM האלחוטית. אנא נסה להעלות שוב את מכשיר המטופל.
- הבהוב בקצב מהיר
  המחוון מהבהב במקביל למחוון ה-ok כאשר המשדר אינו יכול למצוא רשת. שים לב שבאפשרותך לבדוק את העוצמה והאיכות של האות שלך תחת "פרופיל החשבון" בחשבון שלך.

התנהגות ה-diasend® Transmitter כאשר הכל פועל כשורה:

המשדר מחובר לשקע חשמלי.

המחוון ok הירוק מהבהב בקצב איטי במשך כ-2 דק' בזמן האתחול.

מחוון ה-send הכחול מתחיל להבהב בקצב איטי. המשדר נמצא כעת במצב סטנד-בי', כלומר מוכן לשימוש.

מכשיר מחובר למשדר.

מחוון ה-send הכחול מתחיל להבהב בקצב מהיר כאשר הנתונים מועלים.

אם ההעלאה הסתיימה בהצלחה, מחוון ה-ok הירוק דולק ומחוון ה-send הכחול שוב מתחיל להבהב בקצב איטי. המשדר מוכן כעת לשידור נוסף.

רשימת מכשירים תואמים

להלן רשימה של מכשירים תואמים ל-diasend®. מלבד אם תינתנה הוראות העלאה מפורשות עבור המכשיר בפועל, עליך פשוט לחבר אותו למשדר או לרכזת ה-USB באמצעות כבל ה-USB הספציפי שלו והוא יבצע אוטומטית את ההעלאה. (בקר בכתובת diasend.com לעיון ברשימה העדכנית של מכשירים תואמים ומגבלות ידועות).

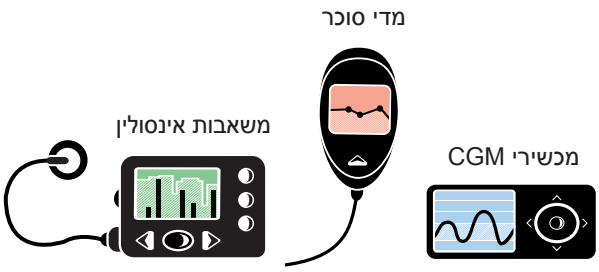

שים לב שחלק ממכשירי המטופלים הבאים עשויים לא להיות זמינים בשוק שלכם.

מדי סוכר ומכשירי CGM - מחוברים עם כבל USB

אנא ודא שרכזת ה-USB מחוברת לשקע חשמלי. כמו כן, שרכזת ה-USB מחוברת ל-diasend® Transmitter.

Abbott

FreeStyle	FreeStyle Optium H
FreeStyle Flash	FreeStyle Papillon
FreeStyle Freedom	FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Freedom Lite	FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Lite	FreeStyle Papillon Vision
Freestyle Mini	FreeStyle Xido
FreeStyle Optium	Optium Mini

כבל Abbott FreeStyle USB (2.5 מ"מ)

FreeStyle InsuLinx	FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Libre	FreeStyle Papillon InsuLinx

Micro USB

FreeStyle Navigator II

Mini USB

FreeStyle Precision	Optium Xido
FreeStyle Precision H	Precision Xceed
Optium Xceed	Precision Xtra

כבל Abbott Xceed USB

המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר ומכשירי CGM – מחוברים עם כבל USB

Acon Laboratories

On Call® Resolve
On Call® Advanced

כבל On Call USB
(2.5 מ"מ)

On Call® Plus
On Call® Vivid

כבל On Call USB
(2.5 מ"מ)

חבר ולחץ על לחצני M ו- **S** במד הסוכר.

חבר ולחץ ממושכות על הלחצן **S** במד-הסוכר.

AgaMatrix

WaveSense Jazz™

כבל AgaMatrix USB

Apex Bio

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

כבל Apex Bio USB



חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

Arkray

Glucocard 01
Glucocard Vital
Glucocard X-meter

Glucocard X-mini plus
Relion Confirm
Relion Prime

כבל Arkray USB
(2.5 מ"מ)

Glucocard Shine

כבל i-Sens USB
(2.5 מ"מ)

חבר ולחץ על כל לחצן.

Glucocard Expression

כבל Glucocard Expression USB
(3,5 מ"מ)



חבר ובחר ב-**PC Link** בתפריט הראשי של מד הסוכר.

Ascensia (Bayer)

Breeze 2

כבל Bayer's blue USB
(3,5 מ"מ)

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT

כבל Bayer's blue USB
(3,5 מ"מ)

חבר ולחץ על לחצן ה-M במד הסוכר.

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד-הסוכר.

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Micro USB

Contour next link
Contour next link 2.4
Contour USB
Contour next USB

חיבור USB במד

המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר ומכשירי CGM – מחוברים עם כבל USB

Beurer

GL50 evo

חיבור USB במד

B. Braun

Omnitest 5

Micro USB

Cambridge Sensors

Microdot+

כבל USB +Microdot
(2.5 מ"מ)

Dexcom

G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Reciever G5/G6

Micro USB

SEVEN PLUS

כבל Seven Plus USB
(Micro USB)

אם ההעלאה אינה מתחילה, נתק את מד הסוכר, בחר **Shutdown** מהתפריט כדי לכבות את המד. הדלק שוב את מד הסוכר וחבר אותו למשדר.

Diastesse

XPER

Mini USB

Everymed

EveryX3

Micro USB

חבר ולחץ על הלחצן **OK** של מד הסוכר.

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB

GE

GE100

כבל USB Bionime (Pura + Rightest)

המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר ומכשירי CGM – מחוברים עם כבל USB

GlucoRx

HCT & Ketone Nexus | Nexus Mini Q

Mini USB

Nexus Mini Ultra

GlucoRx Strip Connector
כבל USB

Nexus Voice

GlucoRx Nexus
כבל Voice USB
(2.5 מ"מ)

iCare

PalmDoc I

i-Care Palmdoc I
כבל USB
(2.5 מ"מ)

PalmDoc II

Mini USB

Infopia

Element
Fintest Lite
GluNEO
GlucoLab

Infopia USB כבל
(2.5 מ"מ)

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS
alphacheck professional

Mini USB

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד-הסוכר.

CareSens BGMS/TEE2 | CareSens N POP
CareSens COOL/Bravo | CareSens N Voice
CareSens N

i-Sens USB כבל
(2.5 מ"מ)

חבר ולחץ על הלחצן **S** (**C**) של מד הסוכר.

Inside Biometrics

KEYA Smart

Micro USB

חבר ובחר ב-**USB** > **Data TX** בתפריט הראשי של מד הסוכר.

המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר ומכשירי CGM – מחוברים עם כבל USB

LifeScan

OneTouch Ping

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

כבל LifeScan USB
(2.5 מ"מ)

OneTouch UltraSmart

כבל LifeScan USB
(2.5 מ"מ)

חבר ולחץ על כל לחצן.

Medcore

Care



כבל Medcore care USB
(3.5 מ"מ)

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

GlucoSure Extra
GlucoSure Max



כבל Medcore USB

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GLUCOFIX TECH

כבל Menarini GlucoMen areo USB (2,5 מ"מ)

GlucoMen Gm
Glucofix iD
Glucocard MX

כבל Menarini white USB (2,5 מ"מ)

אם מד הסוכר מציג: **E-3**, נתק אותו והמתן עד שהצג ייכבה, וחבר אותו שוב.

GLUCOCARD SM

המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר ומכשירי CGM – מחוברים עם כבל USB

GlucoMen READY

כבל Mendor discreet USB (2,5 מ"מ)

GlucoMen Visio

כבל Menarini GlucoMen Visio USB



חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

GlucoMen LX
Glucofix miò

כבל Menarini strip למחבר USB

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
Glucofix miò Plus
Glucofix Premium

כבל Menarini blue USB (3.5 מ"מ)

אם מד הסוכר מציג: **E-3**, נתק אותו והמתן עד שהצג יכבה, וחבר אותו שוב.

GlucoMen G+

כבל Menarini white USB (3,5 מ"מ)

Mendor

Discreet

כבל Mendor discreet USB (2,5 מ"מ)

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

Nipro

4SURE Smart
4SURE Smart Duo

Micro USB

TRUEresult
TRUE METRIX
TRUE METRIX AIR

תחנת Nipro TRUEresult USB עגינה מסוג

חבר ומקם את מד הסוכר בתחנת העגינה.

TRUEyou
TRUEyou mini

תחנת Nipro TRUEresult USB עגינה מסוג

חבר ומקם את מד הסוכר בתחנת העגינה.

Nova

Max Link
Max Plus

כבל Nova USB

Pic Solution

Pic GlucoTest

כבל Pic Solution USB

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

Prodigy

AutoCode

Mini USB

מדי סוכר ומכשירי CGM - מחוברים עם כבל USB

Roche Accu-Chek

Active
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect
Guide
Instant
Instant S

Micro USB

1. לאחר החיבור, ההעלאה צריכה להתחיל בתוך 20 שניות לאחר חיבור הכבל. אם לא,
2. עבור לתפריט הראשי במד הסוכר. עבור ל-**Reports** > **Data Transfer** > **My data**,
וחבר שוב את מד הסוכר לכבל ה-USB.
(אל תחזיק את שני לחצני החצים לחוצים)

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

כבל Sanofi USB



הערה!
לא ניתן להעלות את Eversense Smart Transmitter (CGM) דרך diasend® Transmitter.

Senseonics

Eversense CGM Transmitter

ניתן להעלות את הנתונים מ-Eversense CGM אל diasend® רק דרך היישום '**חבר אפליקציה**' בחשבון diasend® של המטופל. עיין בהוראות נוספות במדריך למשתמש עבור מטופלים בכתובת:
https://support.diasend.com

Terumo

Finetouch

כבל Terumo USB



VivaChek

Fad

כבל VivaChek USB



חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של מד הסוכר.

Wellion

Calla Dialog

כבל Wellion Calla USB
(3.5 מ"מ)

חבר ובחר ב-**PC Link** בתפריט הראשי של מד הסוכר.

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo GLU/KET
Leonardo GLU/KET
Galileo GLU/CHOL
Leonardo GLU/CHOL

כבל Wellion Calla mini USB

Linus

כבל Wellion Linus USB



Ypsomed

mylife Pura

כבל mylife Pura USB

mylife Unio

Mini USB

מדי סוכר באינפרה-אדום

העבר את מד הסוכר למצב העלאה תוך הקפדה על מילוי ההוראות שלהלן. מקם את הקצה העליון של מד הסוכר כשהוא מכוון לעבר עינית ה-IR על ה-diasend® Transmitter.

ודא שהמכשיר ייוותר במנוחה מוחלטת במהלך ההעלאה. אל תסיר את המכשיר עד אשר המחוון ok הירוק יידלק.

Roche

Accu-Chek Aviva Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa		הפעל את שידור ה-IR על ידי לחיצה ממושכת על שני לחצני החצים עד אשר יופיעו שני חיצים על הצג.
Accu-Chek Compact		הפעל את שידור ה-IR על ידי לחיצה ממושכת על שני הלחצנים העליונים של מד הסוכר עד אשר יופיעו שני חיצים על הצג.
Accu-Chek Compact Plus		הפעל את שידור ה-IR על ידי לחיצה ממושכת על הלחצנים **S** ו-**M** מתחת לצג עד אשר יופיעו שני חיצים על הצג.
Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Expert		בתפריט הראשי, עבור ל-My data ובחר ב-Data transfer.
Accu-Chek Mobile (IR)		1. לחץ ממושכות על שני לחצני החצים. 2. בתפריט העברת הנתונים, בחר באפשרות הראשונה (**for analysis**). הערה: אם המספר הסידורי של מד הסוכר מתחיל ב-U1, עיין בהוראות עבור Accu-Chek Mobile (USB) בעמוד 16.

מדי סוכר מסוג Bluetooth

כדי להיות מסוגלים לשדר נתונים ממכשירי Bluetooth, אתה זקוק למתאם USB Bluetooth. Bluetooth בתור שיטת שידור מצריכה שהמכשיר ימוקם בקרבת ה-diasend® Transmitter.

Abbott

FreeStyle Navigator

במד הסוכר, עבור ל-**Menu** > **System** > **Upload**.
בחר ואשר הפעלה.

FORACARE

FORA Diamond MINI

1. כדי להפוך את Bluetooth לזמין, הדלק את מד הסוכר על ידי החזקה כלפי מטה של לחצן ההפעלה.
2. כבה את מד הסוכר על ידי החזקה כלפי מטה של לחצן ההפעלה. מחוון ה-LED בפינה הימנית התחתונה של מד הסוכר מהבהב בכחול כדי לציין שה-Bluetooth מופעל. לאחר נכן הוא מתייצב כדי לציין שהנתונים מועלים.

הערה: הגרסה הנתמכת היא זאת עם Bluetooth משולב.

משאבות אינסולין - מחוברות בכבל USB רגיל

Insulet

- OmniPod — Mini USB
- OmniPod Dash — Micro USB

Tandem

- t:flex, t:slim, t:slim X2, t:slim G4 — Micro USB

ViCentra

- Kaleido — Micro USB

Ypsomed

- mylife OmniPod — Mini USB

התחבר ולחץ על לחצן ההפעלה של ה-PDM.

עבור אל התפריט הצהוב ובחר העלאת נתונים.

משאבות אינסולין באינפרה-אדום

עבור משאבות Animas: ודא שהמשאבה אינה פועלת והמסך מואר כאשר השידור מתחיל (אולם המסך אינו חייב להיות מואר במהלך כל השידור). שמור על המשאבה במצב מנוחה מוחלטת ואל תסיר את המשאבה עד אשר מחוון ה-ok הירוק נדלק.

Animas

IR1200
IR1250
2020
OneTouch Ping
OneTouch Vibe Plus
Vibe

1. עצור את המשאבה. (תפריט ראשי, גלול אל **Suspnd/Resum** ולחץ על **OK**; **Suspend** מודגש)
2. לחץ על **OK**.
3. מקם את המשאבה כאשר צידה האחורי פונה לעבר עינית ה-IR על המשדר.
4. בתום השידור:
הפעל מחדש את המשאבה (תפריט ראשי, גלול אל **Suspnd/Resum** ולחץ על **OK**; הפעל מחדש מודגש). לחץ על **OK**.

Smiths Medical

CoZmo 1700

1. לחץ על לחצן החץ למטה כדי להפעיל את המשאבה.
2. מקם את המשאבה כאשר צידה האחורי פונה לעבר מרכז הפנל הקדמי של ה-diasend® Transmitter.

הערה: הסוללה במשאבת האינסולין CoZmo חייבת להיות טעונה היטב כדי לשדר בהצלחה!

משאבות אינסולין – מחוברות עם כבלי אינפרה-אדום

כבלי אינפרה-אדום תואמים

כבל Roche Accu-Chek Smart Pix 2

כבל Roche Accu-Chek Smart Pix

Roche

Accu-Chek Insight

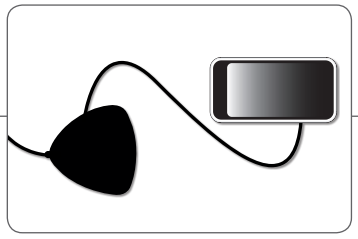

Smart Pix 2

שים לב! חבר את השפופרת של המשאבה שלך עם כבל מיקרו USB אל ה-Smart Pix 2.

1. חבר את כבל ה-Smart Pix 2 למשדר והמתן עד אשר המחוון הכחול על ה-Smart Pix 2 יתחיל להבהב בקצב איטי.
2. חבר את השפופרת ל-Smart Pix 2 עם כבל מיקרו USB.
3. בתפריט של שפופרת הטלפון, בחר באפשרות **Connect to PC** ולחץ על **OK**.
4. ודא שהמשאבה נמצאת בטווח של השפופרת.
5. המחוון הכחול ב-Smart Pix 2 דולק בעת שהנתונים מועברים מהמכשיר ל-Smart Pix 2.
6. המחוון הכחול נכבה והה-Smart Pix 2 וגם המכשיר משמיעים קול כדי לסמן שהנתונים מועברים מה-Smart Pix 2 אל המשדר. אל תנתק את Smart Pix 2 עדיין!
7. המתן עד אשר המשדר יסמן שההעלאה הסתיימה בהצלחה (מחוון ok ירוק עם אור יציב).

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix או Smart Pix 2

שים לב! נדרשת גרסת תוכנת Smart Pix 3.02 או מאוחרת יותר כאשר משתמשים ב-Smart Pix.

1. חבר את ה-Smart Pix למשדר והמתן עד אשר המחוון הכחול ב- Smart Pix יתחיל להבהב בקצב איטי.
2. העבר את המשאבה ל-mode **Data Transfer** (עצור את המשאבה ועבור לתפריט **Data Transfer**).
3. מקם את המשאבה כאשר עינית האינפרה-אדום פונה לכיוון Smart Pix. המחוון הכחול מסמן שנתונים משודרים ל- Smart Pix.
4. המתן עד שהמחוון הכחול יתחיל להבהב שוב בקצב איטי או יפסיק להבהב לחלוטין.
5. הנתונים מועברים כעת מה-Smart Pix למשדר. אל תנתק את Smart Pix עדיין!
6. המתן עד אשר המשדר יסמן שההעלאה הסתיימה בהצלחה (מחוון ok ירוק עם אור יציב).

משאבות אינסולין Bluetooth

כדי להיות מסוגלים לשדר נתונים ממכשירי Bluetooth, אתה זקוק למתאם USB Bluetooth. Bluetooth כשיטת העברת נתונים דורשת שהמכשיר ימוקם בקרבת ה-diasend® Transmitter.

SOOIL

DANA Diabecare R

1. בחר בתפריט ראשי.
2. עבור ל-**Setting**.
3. בחר ב-**Discovery**.
4. מחוון ה-send צריך להתחיל להבהב בקצב מהיר. אם לא, והמשאבה נכבית, נסה שוב.
5. המתן עד שמחוון ה-send מפסיק להבהב בקצב מהיר ומחוון ה-ok נדלק.

עטי אינסולין - מחוברים עם כבל USB סטנדרטי

כדי להיות מסוגלים לשדר נתונים מעט אינסולין, נהג לפי ההוראות שלהלן.

אנא ודא שרכזת ה-USB מחוברת לשקע חשמלי. וכן שרכזת ה-USB מחוברת ל-diasend® Transmitter.

Pendiq

pendiq

Mini USB

ודא שהכבל מוכנס כהלכה. נורת הבקרה של עט האינסולין תתחיל להבהב וההעלאה תתחיל לאחר 10-15 שניות.

אזהרה!

כל האבחונים והטיפולים הרפואיים במטופלים יתבצעו תחת פיקוח של אנשי מקצוע מוסמכים של שירותי הרפואה! ®diasend לא נועד לספק החלטות טיפול אוטומטיות או לשמש כתחליף לשיקולי אנשי המקצוע של שירותי הרפואה. ®diasend לא נועד לטיפול במצבי חירום או לצורך שידור או התוויה של התראות בזמן אמת או של נתונים במצבים קריטיים! ®diasend לא נועד לשמש כתחליף לפיקוח רפואי ישיר או לצורך התערבות במצב חירום.

הכימת

+46 (0)31-762 08 88
support@diasend.com
www.diasend.com

CE

A2032v15P QG_he_diasend-clinic (2019-02-12)

®diasend מתווה לשימוש על ידי אנשים פרטיים או מטפלים רפואיים בבית או במוסדות בריאות, לצורך שידור נתונים ממכשירי ניטור ביתיים - כגון מדי סוכר ומשאבות אינסולין - למסד נתונים בשרת כחלק מהטיפול בסוכרת. ®diasend מתווה לשימוש מקצועי ולמכירה ללא מרשם.